
**CARTA PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PRESTADORA DE
SERVIÇO DE SAÚDE JUNTO AO CBMDF**

Ao Sr. Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento.

A PERFECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, sediada no SGAS 611, Centro Médico Lúcio Costa Bloco 1 sala S-03, Brasília-DF, CEP 70.200-700, telefone (61) 3245 5872 e e-mail comercial@perfectadiagnostico.com.br, de CNPJ nº 38.020.020/0002-88, na condição de Organização Civil de Saúde inscrita no CRM/DF, sob o nº 3947/DF, vem requerer seu credenciamento junto a esta Corporação, no intuito de oferecer seus serviços aos beneficiários do Sistema de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, visto que adequa-se ao previsto no subitem nº 4.19 do item 4 do Projeto Básico nº 35/2017-DIMAT, Anexo I ao Edital de Credenciamento Nº 001/2018-CBMDF, a saber:

- Empresas especializadas em radiologia, que realizem procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou não.


Compromete-se desde já a oferecer, dentro da referida modalidade de atividade, os seguintes serviços: Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

Domicílio bancário para faturamento da empresa: Banco do Brasil Ag 3478-9 cc 105.492-9

Para prestar quaisquer esclarecimentos relativos a esta proposta, bem como para agendamento da vistoria técnica de habilitação à contratação, favor contatar o(a) Sr.(a) Aliete Costa, pelo telefone nº 61 3245 5872 e WhatsApp nº 9 9248 0353. Para efeito do ora requerido, seguem anexos os demais documentos exigidos pelo Projeto Básico nº 35/2017-DIMAT e Edital nº 001/2018-CBMDF, pelo qual esta empresa declara estar de pleno acordo com todas as suas cláusulas e condições.

Informamos também que a Sr. Daniela Vieira de Queiroz Cavalcanti, portador do RG nº 2.173.456 SSP-DF e CPF nº 000.790.384-76, comunicável pelo telefone nº 61 3245 5872 e WhatsApp nº 9 8173 5651, fica instituída, neste ato, como preposto, dotado de plenos poderes para representar legalmente e intervir em nome desta interessada.

Brasília - DF, 06 de abril de 2021.



Daniela Vieira de Queiroz Cavalcanti

Representante legal



PERFECTA
SOLUÇÕES EM SAÚDE

**CARTA PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PRESTADORA DE
SERVIÇO DE SAÚDE JUNTO AO CRMDF**

Ào Sr. Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

A PERFECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, sediada no SGAS 911, Centro Médico Lúcio
Gomes, Bloco 7 sala B-03 Brasília-DF CEP: 70200-700 telefone (61) 3242 5873 e e-mail
contato@perfectadiagnostico.com.br de CNPJ nº 36.020.020/0002-88, na condição de Organização
CIVIL de Saúde inscrita no CRMDF, sob o nº 35470DF, vem requerer seu credenciamento junto a esta
Comissão, no intuito de oferecer seus serviços nos hospitais do Sistema de Saúde do Corpo de
Fornecedores Militar do Distrito Federal, visto que adequa-se ao previsto no edital nº 419 de 14 de
Fevereiro de 2021 nº 3252017-DIMAT, Anexo I ao Edital de Credenciamento Nº 00152018-CRMDF, a saber:

* Empresas especializadas em radiologia, que realizem procedimentos diagnósticos e/ou
terapêuticos por imagem, invasivos ou não.

Compromete-se desde já a crescer, dentro da máxima modalidade de atividade, os seguintes
serviços: Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Comitê bancário para levantamento da empresa: Banco do Brasil Ag 3478-9 ou 108482-9

Para prestar quaisquer esclarecimentos relativos a esta proposta, bem como para agendamento
de visitas técnicas de finalização a contratação, favor contactar o(a) Sr.(a) Alaine Costa pelo telefone nº
61 3242 5873 e WhatsApp nº 6 3242 5873. Para efeito do ora requerido, seguem anexos as demais
documentos exigidos pelo Projeto Básico nº 3252017-DIMAT e Edital nº 00152018-CRMDF, pelo qual
esta empresa declara estar de pleno acordo com todas as suas cláusulas e condições.

Informamos também que a Sr. Daniela Veira de Queiroz Cavalcanti, portador do RG nº
2.173.455-259-DF e CPF nº 000.790.384-76, comunicável pelo telefone nº 61 3242 5873 e WhatsApp
nº 6 3242 5873 foi incluída neste ato, como proposta, doravante as planas poderá para representar
legitimamente a interessada em nome desta interessada.

Brasília - DF, 08 de abril de 2021.


Daniela Veira de Queiroz Cavalcanti
Representante legal



PERFECTA
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Levantamento dos aparelhos, equipamentos e materiais

ANEXO

Descritivo de ambientes e instalações físicas

Nossa unidade tem localização privilegiada, com o projeto voltado à comodidade do paciente, aliada a aparatos tecnológicos que propiciem o pleno desenvolvimento de nossa atividade.



CENTRO MÉDICO LÚCIO COSTA – AV. L2 SUL



RECEPÇÃO CLÍNICA PERFECTA

- Instalações planejadas para a mobilidade e conforto dos pacientes, com amplos corredores, elevadores, banheiro PNE e trocador (fraldário).
- Ampla recepção, 2 salas de ultrassom, 2 salas de ressonância, 1 sala de Tomografia
- 3 espaços de espera internos, para evitarmos aglomerações

- Espaço totalmente reservado à saúde da mulher, com total privacidade e corpo assistencial do mesmo sexo onde, além da Ecografia, é feito o acesso para as salas de Densitometria e Mamografia.

ESPAÇO
Mulher
Atendimento que acolhe



- Certificação de Qualidade de Imagens, reconhecida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia

- CBR

000 202 122-82	CRM 398 - DF	Neurologia	Dr. Luis Furtado
044 312 529-41	CRM 24.741-DF	Radiologia e Diagnóstico por imagem	Dr. Agostinho da Oliveira
308 512 007-81	CRM 2294 - DF	Cardiologia, Clínica Médica	Dr. Nércia Aballa Teixeira da Costa
014 394 931-88	CRM 17187-DF	Radiologia e Diagnóstico por imagem	Dr. Márcio Glawe Gomes Maciel



AT PERFECTA
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Levantamento dos aparelhos, equipamentos e maquinários

01	Ressonância Magnética Siemens Aera de 1,5 Tesla e diâmetro de 70cm, com capacidade para pacientes com até 250kg e música durante o exame
01	Ressonância Magnética GE Signa de 1,5 Tesla
01	Tomografia Computadorizada Multislice GE- Tecnologia SMART DOSE, permitindo a redução de até 40% de radiação, com redutor de dose de radiação.
01	Densitometria Óssea GE - para adultos e crianças com medidas DEXA e de corpo inteiro - Tecnologia SMART DOSE, permitindo a redução de até 40% de radiação. com redutor de dose de radiação.
01	Mamografia Digital GE - Tecnologia SMART DOSE, permitindo a redução de até 40% de radiação. com redutor de dose de radiação.
01	Ecógrafo Samsung Voluson S06 - Doppler colorido e imagens 3D
01	Ecógrafo Samsung S50 - Doppler colorido e imagens 3D

Relação do Corpo Clínico

	Nome	Especialidade	Registro no Conselho	CPF
1	Adriana Costa Vêras	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 9.891-DF	460.424.403-06
2	Ana Graziela Santana Anton	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 16.421-DF	721.276.431-00
3	Bruno Henry de Medeiros	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 14.446-DF	026.119.874-24
4	Carla Maria da Silva Araújo	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 14.935-DF	442.688.314-87
5	Cilmário Leite da Silva Junior	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 28.043-DF	037.027.191-21
6	Gibran Younes Rahhal	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 19213-DF	087.267.187-90
7	Guilherme Urpia Monte	Cardiologia, Clínica Médica	CRM 13.375-DF	673.249.165-20
8	João Victor Lopes dos Santos	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 28.512-DF	037.333.171-14
9	José Alberto Covre Soares	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 16.646-DF	014.698.986-40
10	José Luiz Furtado de Mendonça	Neuroradiologia	CRM 369 - DF	000.265.141-68
11	José Walter Agostinho de Oliveira	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 24.741-DF	064.312.624-41
12	Márcia Abdalla Teixeira da Costa	Cardiologia, Clínica Médica	CRM 5234 - DF	309.213.097-91
13	Márcio Olavo Gomes Magalhães	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 17167-DF	014.334.971-66



PERFECTA
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

14	Mariana Mendes da Costa Bae	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 19869-DF	025.748.091-90
15	Murilo Campos Calegari	Radiologia e Diagnóstico por Imagem em Oncologia	CRM 21904-DF	070.346.006-43
16	Philipe Bronzeado Cavalcanti	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 10.103-DF	753.804.554-68
17	Rodrigo Rodrigues da Cunha	Radiologia e Diagnóstico por Imagem	CRM 26706-DF	022.223.871-24

Declaramos que todos os profissionais aqui relacionados são devidamente habilitados e plenamente competentes para o exercício de suas funções, conforme suas especialidades.

Dias e Horários de Funcionamento:

De 2ª a 6ª feira – das 07h00 às 22h00

Sábados, Domingos e Feriados: de 07h00 às 19h00

Obs.: Temporariamente, devido à atual pandemia do COVID-19, estamos com horários de atendimento reduzidos, não atendendo à noite

ANEXO I – RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

COD TUSS	Ressonância Nuclear Magnética em Geral
41101014	Crânio (encéfalo)
41101022	Sela turcica (hipófise)
41101030	Base do Cranio
41101057	Perfusão Cerebral por RM
41101065	Espectroscopia por RM
41101073	Órbita bilateral
41101081	Ossos temporais bilateral
41101090	Face (inclui seios da face)
41101103	Articulação temporomandibular (bilateral)
41101111	Pescoço (nasofaringe, orofaringe, laringe, traquéia, tireóide, paratireóide)
41101120	Tórax (mediastino, pulmão, parede torácica)
41101138	Coração - morfológico e funcional
41101154	Coração – morfológico e funcional + perfusão + viabilidade miocárdica
41101162	Mama (unilateral)
41101170	Abdome superior (fígado, pâncreas, baço, rins, supra-renais, retroperitônio)
41101189	Pelve (não inclui articulações coxofemorais)
41101197	RM Fetal
41101200	Pênis
41101219	Bolsa escrotal
41101227	Coluna cervical ou dorsal ou lombar
41101235	Fluxo liquorico (como complementar)
41101243	Plexo braquial (desfiladeiro torácico) ou lombossacral (não inclui coluna cervical ou lombar)



AT PERFECTA
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

41101251	Membro superior unilateral (não inclui mão e articulações)
41101260	Mão (não inclui punho)
41101278	Bacia (articulações sacroilíacas)
41101286	Coxa (unilateral)
41101294	Perna (unilateral)
41101308	Pé (antepé) - não inclui tornozelo
41101316	Articular (por articulação)
41101464	Multiparamétrica da próstata
41101642	RM Aparelho urinário
41101324	Angio-RM (crânio ou pescoço ou tórax ou abdome superior ou pelve) - arterial ou venosa
41101332	Angio-RM de aorta torácica
41101340	Angio-RM de aorta abdominal
41101359	Hidro-RM (colângio-RM ou uro-RM ou mielo-RM ou sialo-RM ou cistografia por RM)
41101510	Angio-Rm Arterial De Abdome Superior
41101529	Angio-Rm Venosa De Abdome Superior
41101537	Angio-Rm Arterial De Crânio
41101545	Angio-Rm Venosa De Crânio
41101596	Angio-Rm Arterial De Pelve
41101600	Angio-Rm Venosa De Pelve
41101618	Angio-Rm Arterial De Pescoço
41101626	Angio-Rm Venosa De Pescoço
41101499	Angio-Rm Arterial Pulmonar
41101502	Angio-Rm Venosa Pulmonar
41101510	Angio-Rm Arterial De Abdome Superior
COD TUSS	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DIAGNÓSTICA
41001010	Tc - Crânio Ou Sela Túrcica Ou Órbitas
41001028	Tc - Mastóides Ou Orelhas
41001036	Tc - Face Ou Seios Da Face
41001044	Tc - Articulações Temporomandibulares
41001052	Tc - Dental (Dentascan)
41001060	Tc - Pescoço (Partes Moles, Laringe, Tireóide, Faringe E Glândulas Salivares)
41001079	Tc - Tórax
41001095	Tc - Abdome Total (Abdome Superior, Pelve E Retroperitônio)
41001109	Tc - Abdome Superior
41001117	Tc - Pelve Ou Bacia
41001125	Tc - Coluna Cervical Ou Dorsal Ou Lombo-Sacra (Até 3 Segmentos)
41001133	Tc - Coluna - Segmento Adicional
41001141	Tc - Articulação (Esternoclavicular Ou Ombro Ou Cotovelo Ou Punho Ou Sacroilíacas Ou Coxofemoral Ou Joelho Ou Tornozelo) - Unilateral
41001150	Tc - Segmento Apendicular (Braço Ou Antebraço Ou Mão Ou Coxa Ou Perna Ou Pé) - Unilateral
41001176	Angiotomografia De Aorta Torácica
41001184	Angiotomografia De Aorta Abdominal
41001192	Tc - Escanometria Digital
41001206	Tc - Reconstrução Tridimensional De Qualquer Órgão Ou Estrutura - Acrescentar Ao Exame De Base



AT PERFECTA

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

41001214	Endoscopia Virtual De Qualquer Órgão Ou Estrutura Por Tc - Acrescentar Ao Exame De Base
41001265	TC – Colonoscopia Virtual (colonografia)
41001273	Tc - Mandíbula
41001281	Tc - Maxilar
41001370	Angiotomografia Arterial De Crânio
41001389	Angiotomografia Venosa De Crânio
41001397	Angiotomografia Arterial De Pescoço
41001400	Angiotomografia Venosa De Pescoço
41001419	Angiotomografia Arterial De Tórax
41001427	Angiotomografia Venosa De Tórax
41001435	Angiotomografia Arterial De Abdome Superior
41001443	Angiotomografia Venosa De Abdome Superior
41001451	Angiotomografia Arterial De Pelve
41001460	Angiotomografia Venosa De Pelve
41001478	Angiotomografia Arterial De Membro Inferior
41001486	Angiotomografia Venosa De Membro Inferior
41001494	Angiotomografia Arterial De Membro Superior
41001508	Angiotomografia Venosa De Membro Superior
41001516	Angiotomografia Arterial Pulmonar
41001524	Angiotomografia Venosa Pulmonar
41002040	TC - Punção para introdução de contraste (acrescentar o exame de base)
COD TUSS	ULTRASSONOGRRAFIA DIAGNÓSTICA
40808084	Punção biópsia/aspirativa mamária orientada por US - por nódulo (acrescentar o exame base)
40809099	Punção biópsia/aspirativa de tireoide orientada por US - por nódulo(acrescentar o exame base)
40808262	Biópsia percutânea fragmento mamário (Core Biopsy) por nódulo
40901017	Globo Ocular
40901025	Globo ocular com Doppler Colorido
40901130	Abdome superior (fígado, vias biliares, vesícula, pâncreas, baço)
40901122	Abdome total (inclui abdome inferior)
40901769	Aparelho urinário feminino (rins, ureteres e bexiga)
40901033	Glândulas salivares
40901238	Obstétrica
40901203	Órgãos superficiais (tireóide ou escroto ou pênis ou crânio)
40901181	Abdome inferior feminino (bexiga, útero, ovário e anexos)
40901300	Transvaginal (inclui abdome inferior feminino)
40901173	Abdome inferior masculino (bexiga, próstata e vesículas seminais)
40901335	Próstata transretal (inclui abdome inferior masculino)
40901149	Retroperitônio (grandes vasos ou adrenais)
40901041	Torácico extracardiaco
40901319	Transvaginal para controle de ovulação (3 ou mais exames) (inclui abdome inferior feminino)
40901114	Mamas
40901165	Aparelho urinário masculino (rins, ureteres, bexiga e próstata)
40901165	Rins e vias urinárias
40901190	Dermatológico - pele e subcutâneo
40901211	Extensão axilar



AT PERFECTA
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

40901211	Estruturas superficiais (cervical ou axilas ou músculo ou tendão)
40901220	Articular (por articulação)
40901246	Obstétrica com doppler
40901254	Obstétrica com translucência nucal
40901262	Obstétrica morfológica
40901270	Obstétrica gestação múltipla: cada feto
40901289	Obstétrica gestação múltipla com Doppler colorido: cada feto
40901297	Obstétrica 1º trimestre (endovaginal)
40901351	Doppler colorido transcraniano ou transfontanela
particular	Doppler Abdome Total para pesquisa de Refluxo - RGE
40901360	Doppler colorido de vasos cervicais arteriais bilateral (carótidas e vertebrais)
40901378	Doppler colorido de vasos cervicais venosos bilateral (subclávias e jugulares)
40901386	Doppler colorido de órgão ou estrutura isolada
40901394	Doppler colorido de aorta e artérias renais
40901408	Doppler colorido de aorta e ilíacas
40901416	Doppler colorido de artérias viscerais (mesentéricas superior e inferior e tronco celíaco)
40901424	Doppler colorido de hemangioma
40901432	Doppler colorido de veia cava superior ou inferior
40901459	Doppler colorido arterial de membro superior - unilateral
40901467	Doppler colorido venoso de membro superior - unilateral
40901475	Doppler colorido arterial de membro inferior - unilateral
40901483	Doppler colorido venoso de membro inferior - unilateral
40901513	Doppler colorido de artérias penianas (sem fármaco indução)
40901130	Doppler Abdome superior (fígado, vias biliares, vesícula, pâncreas, baço)
40901122	Doppler Abdome total (inclui abdome inferior)
40901440	Doppler colorido peniano com fármaco-indução
COD TUSS	MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM / OUTROS EXAMES
40808033	Mamografia digital bilateral
40808050	Ampliação ou magnificação de lesão mamária
40808122	Densitometria óssea (um segmento)
40808130	Densitometria óssea (dois segmentos)
40808149	Densitometria óssea de corpo inteiro
40808157	Avaliação de fraturas vertebrais por DXA

MEMORIAL DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO

SEGUNDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 453 DE JUNHO DE 1998 DO MIN. DA SAÚDE, CAP 3.

– DENSITOMETRIA ÓSSEA –



PERFECTA
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Data LevRad.: 06-01-2020

I. Identificação da Instituição:

I.1	Razão Social:	PERFECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA		
I.2	Endereço:	611 SUL CENTRO MÉDICO LÚCIO COSTA BLOCO 1 SALA S3		
I.3	Email:	gerencia@perfectadiagnostico.com.br		
	Telefone:	(61)32455872	CNPJ:	38.020.020/0002-88
	C.E.P.:	70.200-700	CF/DF:	07.324.008/003-92
I.4	R.T.:	Philipe Bronzeado Cavalcanti	CRM:	10.103 - DF
			CPF:	753.804.554-68

II. Identificação da Empresa Realizadora do Levrad:

Razão Social:	G 7 PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA			
Fantasia:	G7 Proteção Radiológica			
C.N.P.J.:	01.620.776/0001-77	Ins.Est.:	07.367.787/001-49	
		Telefone:	(61) 3244 - 3314	
Endereço:	SEP Sul EQ 705/905 Conj. "A" Sala 205 – Asa Sul – Brasília - D.F.			
E-mail:	g7pr@uol.com.br e kafia@g7pr.com.br		C.E.P.:	70.390-055
Resp. Legal:	Marcia Cristlina de Assis Possa		C.P.F.:	310.251.961-04
Resp. Téc.:	Kafia Cristlina da Silva Caballero		C.P.F.:	703.749.457-72
CNEN:	RT 0082 e FM 0256	ABFM (Sócia):	0751	

III. Identificação do Equipamento Emissor de Raios-X:

III.1 Densitometria Óssea:



III.1.1 Fabricante:

GE

Modelo:

Lunar Prodigy

Tensão:

76 kV

Nº de Série (ID): **510438MA**

Reg. M.S.: **NI**

✓ As informações acima foram retiradas das placas de identificação que constam no equipamento.



IV. Levantamento Radiométrico:

IV.1 Objetivo:

✓ Levantamento radiométrico tem por objetivo verificar se os níveis de exposição ambiental na instalação (sala do equipamento de raios-X - DO) e áreas circunvizinhas são menores do que os níveis de restrições de doses estabelecidos na portaria 453/98 da ANVISA/MS.

IV.2 Referências:

Tabela 1 - Nível de Restrição de Dose

	CONTROLADA	LIVRE
Anual	5 mSv	0,5 mSv
Semanal	0,10 mSv	0,01 mSv

IV.3 Instrumentação:

1. Dosímetro Radcal

	Modelo	Nº Série	Nº do Certificado de Calibração	Data de Calibração	Fator de Calibração
Eletrômetro:	2026 C	1281	—	—	—
Câmaras de Ionização:	20X6-1800	32115	C 273-19	17/10/2019	0,01448

2. Fantoma simulador com água (elemento espalhador).

IV.4 Carga de Trabalho:

✓ O passo inicial no levantamento radiométrico é o estabelecimento da **Carga de Trabalho** do equipamento emissor de raios – X. A carga de trabalho (W) de um serviço é igual ao somatório dos produtos da corrente pelo tempo (mA.s) utilizados na semana.

Tabela 2 – Carga de Trabalho Estimada da Clínica

Exames	Exam/ Sem	Nº de Incidências	Carga de Trabalho		
			mA	s	W (mA.min/sem)
Coluna	20	1	1,5	420	210,00
Fêmur	20	1	1,5	420	210,00
Densitometria Óssea	-	-	-	-	420,00


IV.5 Medidas do Nível de Radiação: Densitometria Óssea

RADIAÇÃO ESPALHADA

✓ O equipamento de densitometria óssea opera com uma tensão de 76 kV e tem um feixe muito colimado, com direção fixa para mesa de exame e corrente de operação máxima de 3,0 mA. Assim, a radiação espalhada pelo objeto em exame torna-se significativa no perímetro da mesa, mas optamos também por avaliar as áreas adjacentes a sala de exame.

✓ Os respectivos valores com classificação da área estão apresentados na tabela 4.

Croqui:

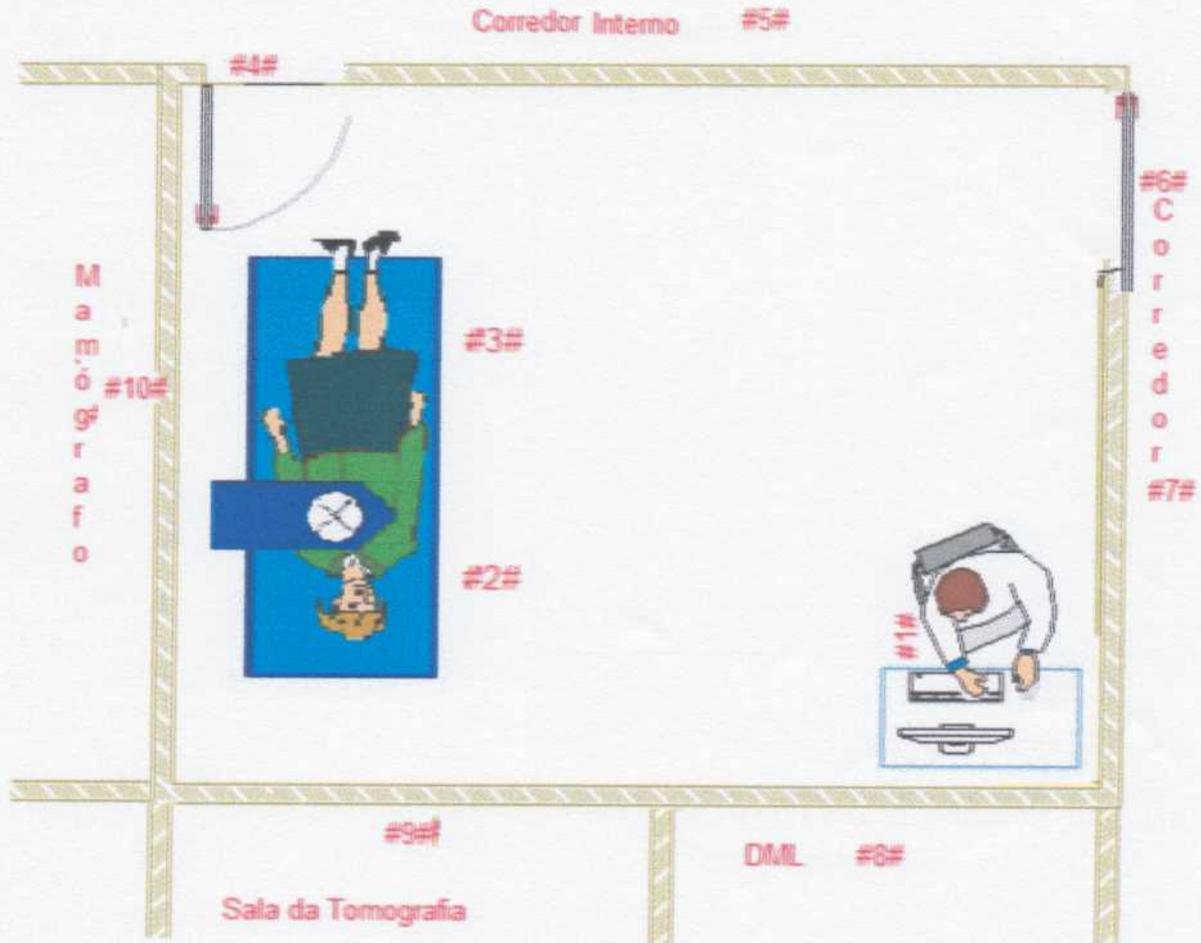

Fatores de Ocupação:

Tabela 3 – Fatores de Uso

Localização	Ocupação	T
✓ Consultório, Recepção.	Integral	1
✓ Sala de espera, vestiário, circulação interna	Parcial	1/4
✓ Circulação externa, banheiros, escadas	Eventual	1/16
✓ Jardins Cercados, casa de máquinas	Rara	1/32

Radiação Espalhada – Densitometria Óssea

Tabela 4 - Valores da Estimativa de Dose Calculada Através do Levantamento Radiométrico

W(mA.min/sem):	420,00	T (°C)	P (kPa)
Parâmetros Operacionais:		Calibração:	22,4
Tensão (kV):	76	Ambiente:	25,0
mAs:	156	Fator Correção T.P.:	1,137
		Fator Calibração (Sv/R):	0,01448

Pontos	Classificação: (Livre / Controlada)	Fatores		Leitura	Dose	Situação
		Uso	Ocupação	Média (µR)	Estimada (mSv/sem)	
#1# - Comando	C	1	1	1,30	0,003458	< 0,1 mSv/sem, em Conformidade
#2# - Perímetro 1	C	1	1	2,40	0,006385	< 0,1 mSv/sem, em Conformidade
#3# - Perímetro 2	C	1	1	2,70	0,007183	< 0,1 mSv/sem, em Conformidade
#4# - Entrada Sala de Exame	L	1	1/4	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#5# - Corredor Int.	L	1	1/4	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#6# - Porta de Correr	L	1	1/4	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#7# - Corredor	L	1	1/4	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#8# - Expurgo	L	1	1/16	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#9# - Sala Tomógrafa	L	1	1	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#10# - Sala Marmógrafo	L	1	1	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade

V. Conclusão:

- ✓ O levantamento radiométrico demonstrou que a blindagem estrutural, da sala de Densitometria Óssea, se encontra **adequadamente** dimensionada para garantir doses ambientais menores do que 0,01 mSv/sem nas áreas livres e 0,1 mSv/sem nas áreas controladas (Portaria 453/98 – Anvisa – MS).

VI. Validade:

Levantamento Radiométrico – Não havendo modificação no "lay out" da instalação, na carga de trabalho e em componentes do equipamento, este relatório é válido por 04 (quatro) anos e deverá ser emitido novo laudo até 05/01/2024.

Brasília, 06 janeiro de 2019.

Luciano C. Freitas
Físico/CNEN RT 0401
ABFM RT 439/1877
G7 Proteção Radiológica

Philip Augusto Caselmir
RT/SPR (Instituição)

MEMORIAL DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E RADIAÇÃO DE FUGA

SEGUNDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 453 DE JUNHO DE 1998 DO MIN. DA SAÚDE, CAP 3.

- MAMOGRAFIA -



PERFECTA
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Data LevRad.: 06-01-2020

I. Identificação da Instituição:

I.1	Razão Social:	PERFECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA		
I.2	Endereço:	611 SUL CENTRO MÉDICO LÚCIO COSTA BLOCO 1 SALA S3		
I.3	Email:	gerencia@perfectadiagnostico.com.br		
	Telefone:	(61)32455872	CNPJ:	38.020.020/0002-88
	C.E.P.:	70.200-700	CF/DF:	07.324.008/003-92
I.4	R.T.:	Philipe Bronzeado Cavalcanti	CRM:	10.103 - DF
			CPF:	753.804.554-68

II. Identificação da Empresa Realizadora do LevRad:

Razão Social:	G 7 PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA		
Fantasia:	G7 Proteção Radiológica		
C.N.P.J.:	01.620.776/0001-77	Ins.Est.: 07.367.787/001-49	Telefone: (61) 3244 - 3314
Endereço:	SEP Sul EQ 705/905 Conj. "A" Sala 205 – Asa Sul – Brasília - D.F.		
E-mail:	g7pr@uol.com.br e kafia@g7pr.com.br	C.E.P.:	70.390-055
Resp. Legal:	Marcia Cristina de Assis Possa	C.P.F.:	310.251.961-04
Resp. Téc.:	Katia Cristina da Silva Caballero	C.P.F.:	703.749.457-72
CNEN:	RT 0082 e FM 0256	ABFM (Sócia):	0751

SEP Sul EQ 705/905 Conj. "A" Sala 205 – Asa Sul
C.E.P.: 70.390-055 Brasília – D.F.
Tel.: (61) 3244-3314 – 9.9988-4799
contato@g7pr.com.br
www.g7pr.com.br

Luciano C. Freitas
Físico CNEN RT 0401
ABFM RT 439/1877

III. Identificação do Equipamento Emissor de Raios-X:

III.1 Mamografia:



III.1.1 Fabricante: **GE**

Modelo: **SENOGRAPHE CRYSTAL NOVA**

Tubo: **M103T**

Tensão Máx: **35 kV**

Nº de Série (ID): **18N000043**

Nº Série: **30973-S8**

Carga (máx): **350 mAs**

Fabricação: **07-2018**

✓ As informações acima foram retiradas das placas de identificação que constam no equipamento.



IV. Levantamento Radiométrico:

IV.1 Objetivo:

✓ Levantamento radiométrico tem por objetivo verificar se os níveis de exposição ambiental na instalação (sala do equipamento de raios-X) e áreas circunvizinhas são menores do que os níveis de restrições de doses estabelecidos na portaria 453/98 da ANVISA/MS.

IV.2 Referências:

Tabela 1 - Nível de Restrição de Dose

	CONTROLADA	LIVRE
Anual	5 mSv	0,5 mSv
Semanal	0,10 mSv	0,01 mSv

IV.3 Instrumentação:

1. Tabela 2 - Dosímetro Radcal,

	Modelo	Nº Série	Nº do Certificado de Calibração	Data de Calibração	Fator de Calibração
Eletrômetro:	2026 C	1281	—	—	—
Câmaras de Ionização:	20X6-1800	32115	C 274-19	17/10/2019	0,007794
	20X6-180	32047	C 274-19	17/10/2019	0,007585

2. Fantoma de Mama – 40 mm de acrílico.

IV.4 Carga de Trabalho:

✓ O passo inicial no levantamento radiométrico é o estabelecimento da **Carga de Trabalho** do equipamento emissor de raios – X. A carga de trabalho (W) de um serviço é igual ao somatório dos produtos da corrente pelo tempo (mA.s) utilizados na semana.

✓ Adotamos a carga de trabalho estabelecido no Manual de Segurança Radiológica da ANVISA – **Radiodiagnóstico Médico: Desempenho de Equipamentos e Segurança**, apresentado na tabela abaixo, para garantir uma maior margem no atendimento, uma vez que a Clínica está iniciando suas atividades.

Tabela 3 – Carga de Trabalho do Manual.

Equipamento	Exames / Sem	Carga de Trabalho
		W (mA.min/sem)
1. Mamografia	24	2000

IV.5 Mamografia:

RADIAÇÃO ESPALHADA

✓ Para estimativa de dose devido a radiação espalhada colocou-se a fonte de radiação na direção vertical a 65 cm do detector com uma janela de colimação fixa em 18 x 24 cm². O fantom simulador de mamografia foi colocado sobre o detector e as exposições foram realizadas conforme os parâmetros operacionais mostrados na tabela 5.



RADIAÇÃO DE FUGA

- ✓ A portaria 453/98 estabelece que a radiação de fuga a 01 metro da fonte de raios-X deverá ser mantida inferior a 1,0 mGy/h
- ✓ As medições foram efetuadas no plano central da câmara de ionização de 20X6-180 e os valores obtidos estão listados na tabela 6.




Fatores de Ocupação:

Tabela 4 – Fatores de Ocupação.

Localização	Ocupação	T
✓ Consultório, Recepção.	Integral	1
✓ Sala de espera, vestiário, circulação interna	Parcial	1/4
✓ Circulação externa, banheiros, escadas	Eventual	1/16
✓ Jardins Cercados, casa de máquinas	Rara	1/32

Croqui:

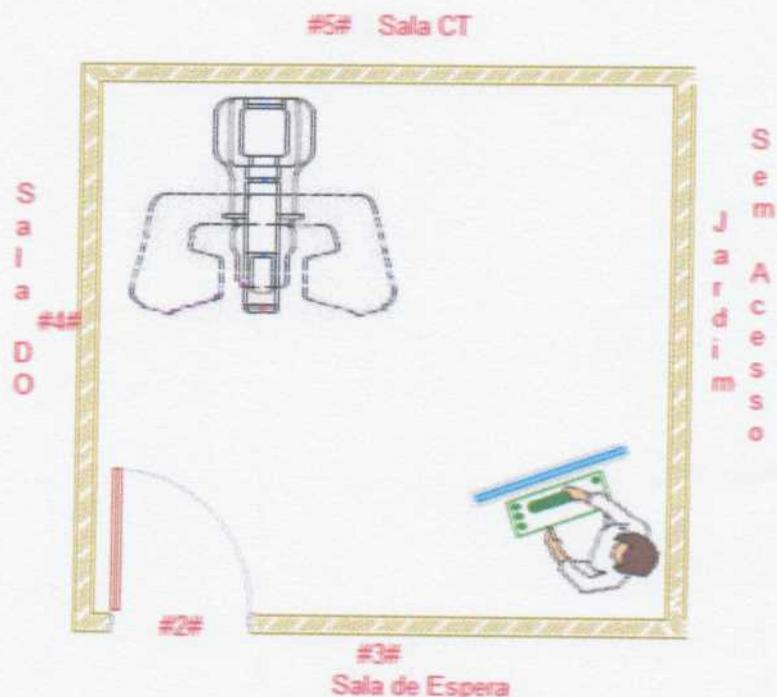

Radiação Espalhada – Mamografia

Tabela 5 - Valores da Estimativa de Dose Calculada Através do Levantamento Radiométrico

W(mAmin/sem):	2000	T (°C)	P (kPa)
Parâmetros Operacionais:		Calibração:	22,1 101,21
Tensão (kV):	35	Ambiente:	25,0 89,8
mAs:	100	Fator Correção T.P.:	1,139
		Fator Calibração (SwR):	0,007794

Pontos	Classificação: (Livre / Controlada)	Fatores		Leitura Média (µR)	Dose Estimada (mSv/sem)	Situação
		Uso	Ocupação			
#1# - Comando	C	1/4	1	1,30	0,000030	< 0,1 mSv/sem, em Conformidade
#2# - Porta Sala Exame	L	1/4	1/4	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#3# - Sala Espera	L	1/4	1/4	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#4# - Sala DO	L	1/4	1/4	0,20	0,000001	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#5# - Sala CT	L	1/4	1/4	0,00	0,000000	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade

Radiação de Fuga – Mamografia

Tabela 6 – Radiação de Fuga do Cabeçote

Tensão (kV):	35			
Corrente Elétrica (mA.s):	100			
Pontos	# 1 #	# 2 #	# 3 #	# 4 #
Distância (cm):	60	60	60	60
Leituras (mR/h):	0,4	0,0	0,0	0,0
R.F. (mGy/h.m ²):	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Situação:	ok	ok	ok	ok

	T (°C)	P (kPa)
Calibração:	22,5	101,25
Ambiente:	25,0	89,8

Fator Correção T,P:	1,137
Fator Calibração:	0,007585

V. Conclusões:

- ✓ O levantamento radiométrico demonstrou que a blindagem estrutural, da sala de Mamografia, está **adequadamente** dimensionada para garantir doses ambientais menores do que 0,01 mSv/sem nas áreas livres e 0,1 mSv/sem nas áreas controladas (Portaria 453/98 – Anvisa – MS).
- ✓ A blindagem do cabeçote está adequada para garantir que a radiação de fuga a 01 metro da fonte de radiação se mantenha inferior a 01 mGy/h (Portaria 453/98 – Anvisa – MS).


VI. Validade:

Levantamento Radiométrico – Não havendo modificação no “lay out” da instalação, na carga de trabalho e em componentes do equipamento, este relatório é válido por 04 (quatro) anos e deverá ser emitido novo laudo até 05/01/2024.

Brasília, 06 de janeiro de 2020.

Luciano C. Freitas
Físico CNEN RT 0401
ABFM RT 439/1877

G7 Proteção Radiológica

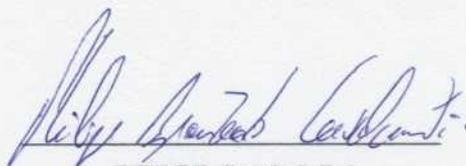
RT/SPR (Instituição)

MEMORIAL DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E RADIÇÃO DE FUGA

SEGUNDO OS TERMOS DA PORTARIA Nº 453 DE JUNHO DE 1998 DO MIN. DA SAÚDE, CAP 3.

– TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA –



PERFECTA
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Data LevRad: **06-01-2020**

I. Identificação da Instituição:

I.1	Razão Social:	PERFECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA		
I.2	Endereço:	611 SUL CENTRO MÉDICO LÚCIO COSTA BLOCO 1 SALA S3		
I.3	Email:	gerencia@perfectadiagnostico.com.br		
	Telefone:	(61)32455872	CNPJ:	38.020.020/0002-88
	C.E.P.:	70.200-700	CF/DF:	07.324.008/003-92
I.4	R.T.:	Philippe Bronzeado Cavalcanti	CRM:	10.103 - DF
			CPF:	753.804.554-68

II. Identificação da Empresa Realizadora do LevRad:


Razão Social:	G 7 PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA		
Fantasia:	G7 Proteção Radiológica		
C.N.P.J.:	01.620.776/0001-77	Ins.Est.:	07.367.787/001-49
		Telefone:	(61) 3244 - 3314
Endereço:	SEP Sul EQ 705/905 Conj. "A" Sala 205 – Asa Sul – Brasília - D.F.		
E-mail:	g7pr@uol.com.br e kafia@g7pr.com.br	C.E.P.:	70.390-055
Resp. Legal:	Marcia Cristlina de Assis Possa	C.P.F.:	310.251.961-04
Resp. Téc.:	Kafia Cristlina da Silva Caballero	C.P.F.:	703.749.457-72
CNEN:	RT 0082 e FM 0256	ABFM (Sócia):	0751

SEP Sul EQ 705/905 Conj. "A" Sala 205 – Asa Sul
C.E.P.: 70.390-055 Brasília – D.F.
Tel.: (61) 3244-3314 – 9.9888-4799
contato@g7pr.com.br
www.g7pr.com.br

Luciano C. Freitas
Físico CNEN RT 0491
ABFM RT 439/1877

III. Identificação do Equipamento Emissor de Raios X:

III.1 Tomografia Computadorizada:

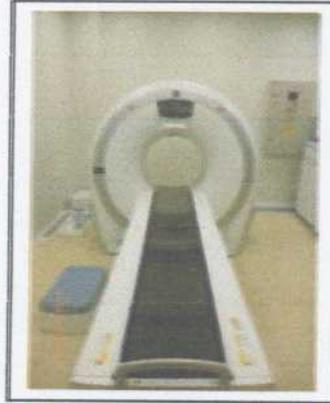

III.1.1 Fabricante: **GE**

Modelo: **REVOLUTION ACTs**

Tubo: **MX_135CTX**

Tensão Máx: **140 kV**


Nº de Série (ID): **57952BG4**

Nº Série: **MX_135CTX**

Corrente (máx): **300 mA**

Fabricação: **Agosto 2019**

✓ As informações acima foram retiradas da placa de identificação que consta no equipamento.

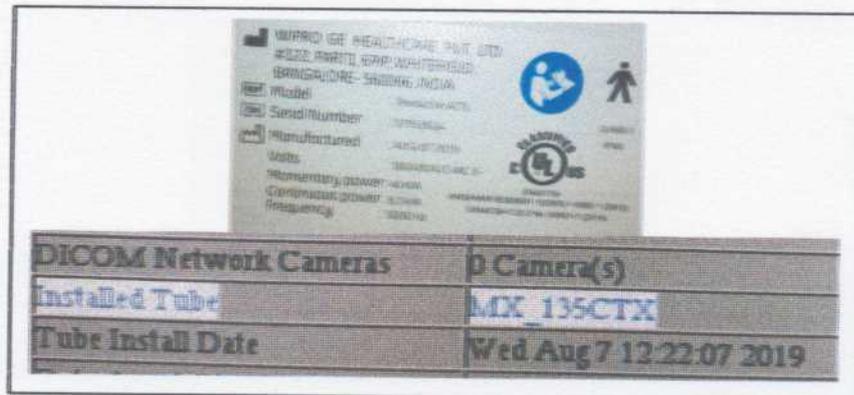

IV. Levantamento Radiométrico:

IV.1 Objetivo:

✓ Levantamento radiométrico tem por objetivo verificar se os níveis de exposição ambiental na instalação (sala do equipamento de raios X) e áreas circunvizinhas são menores do que os níveis de restrições de doses estabelecidos na portaria 453/98 da ANVISA/MS.

IV.2 Referências:

Tabela 1 - Níveis de Restrição de Dose

	CONTROLADA	LIVRE
Annual	5 mSv	0,5 mSv
Semanal	0,10 mSv	0,01 mSv

IV.3 Instrumentação:

1. Dosímetro Radcal,

	Modelo	Nº Série	Nº do Certificado de Calibração	Data de Calibração	Fator de Calibração
Eletrômetro:	2026 C	1281	—	—	—
Câmaras de Ionização:	20X6-1800	32115	C 273-19	17/10/2019	0,01448
	20X6-180	32047	C 273-19	17/10/2019	0,01533

2. Objeto simulador AAPM.

IV.4 Carga de Trabalho:

✓ O passo inicial no levantamento radiométrico é o estabelecimento da **Carga de Trabalho** do equipamento emissor de raios X. A carga de trabalho (W) de um serviço é igual ao somatório dos produtos da corrente pelo tempo (mA.s) utilizados na semana.

✓ Adotamos a carga de trabalho estabelecido no Manual de Segurança Radiológica da ANVISA – **Radiodiagnóstico Médico: Desempenho de Equipamentos e Segurança**, apresentado na tabela abaixo, para garantir uma maior margem no atendimento, uma vez que a Clínica está iniciando suas atividades.

Tabela 2 – Carga de Trabalho do Manual


Equipamento	Exames / dia	Carga de Trabalho
		W (mA.min/sem)
Tomografia Computadorizada	20	20000

IV.5 Tomografia Computadorizada:

RADIAÇÃO ESPALHADA

- ✓ A câmara de ionização 20X6-1800 foi colocada sobre o tripé a uma altura de aproximadamente 1,30 m para levantamento da radiação na vizinhança da sala do tomógrafo.
- ✓ Para o levantamento radiométrico foi utilizado 120 kV, 110 mA, tempo 26 s, espessura de corte de 10 mm, colimação 10 mm, 42 imagens, pitch 1,675, rotação tubo 0,98 s.

- ✓ Os valores obtidos com as respectivas classificações das áreas estão apresentados na Tabela 4.

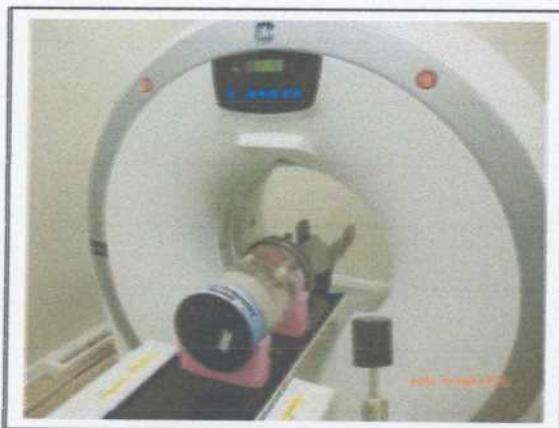


Fatores de Ocupação:

Tabela 3 – Fatores de Ocupação.

Localização	Ocupação	T
✓ Consultório, Recepção.	Integral	1
✓ Sala de espera, vestiário, circulação interna	Parcial	1/4
✓ Circulação externa, banheiros, escadas	Eventual	1/16
✓ Jardins Cercados, casa de máquinas	Rara	1/32

Croqui:

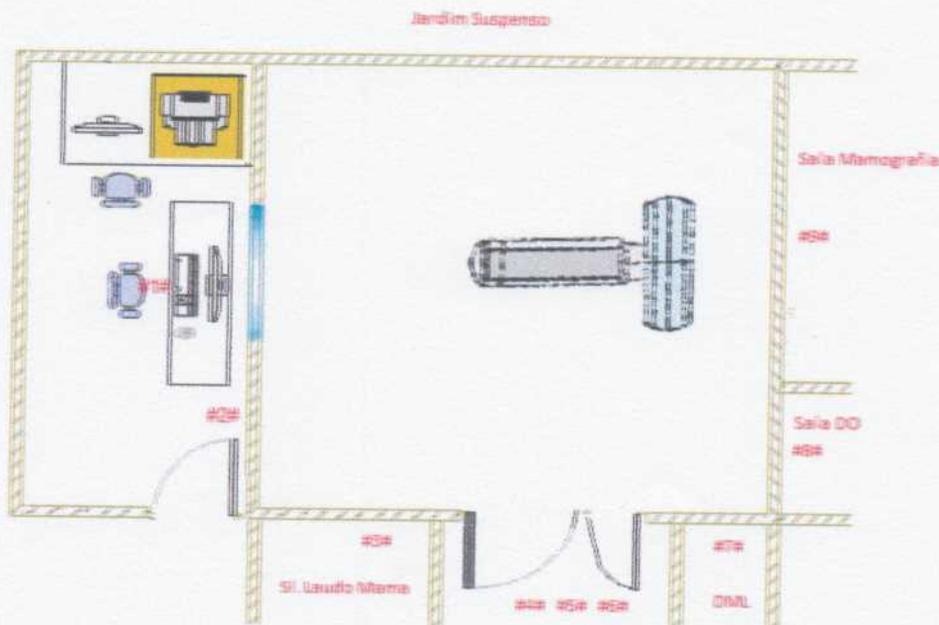

Radiação Espalhada – Tomografia Computadorizada

Tabela 4 - Valores da Estimativa de Dose Calculada Através do Levantamento Radiométrico

W(mA.min/sem):	20000,00	T (°C)	P (kPa)
Parâmetros Operacionais:		Calibração:	22,4 101,2
Tensão (kV):	120	Ambiente:	23,0 90,0
mAs:	2750	Fator Correção T,P:	1,127
		Fator Calibração:	0,01448

Ponto	Classificação: (Livre / Controlada)	Fatores Uso Ocupação	Leitura Média (µR)	Dose Estimada (mSv/sem)	Situação
#1# - Comando	C	1 1	1,30	0,000926	< 0,1 mSv/sem, em Conformidade
#2# - Parede Sala Comando	C	1 1	3,80	0,002706	< 0,1 mSv/sem, em Conformidade
#3# - Sala Laudo Mama	L	1 1/4	1,90	0,000338	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#4# - Porta Sala Exame Esq.	L	1 1/4	2,40	0,000427	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#5# - Porta Sala Exame Cent.	L	1 1/4	3,50	0,000623	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#6# - Porta Sala Exame Dir.	L	1 1/4	2,20	0,000392	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#7# - DML	L	1 1/16	3,90	0,000174	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#8# - Sala DO	L	1 1/4	7,10	0,001264	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade
#9# - Sala Mammografia	L	1 1/4	9,30	0,001655	< 0,01 mSv/sem, em Conformidade

V. Conclusão:


- ✓ O levantamento radiométrico demonstrou que a blindagem estrutural, da sala de Tomografia Computadorizada, está **adequadamente** dimensionada para garantir doses ambientais menores do que 0,01 mSv/sem nas áreas livres e 0,1 mSv/sem nas áreas controladas (Portaria 453/98 – Anvisa – MS).

VI. Validade:


Levantamento Radiométrico – Não havendo modificação no “lay out” da instalação, na carga de trabalho e em componentes do equipamento, este relatório é válido por **04 (quatro) anos** e **deverá ser emitido novo laudo até 05/01/2024.**

Brasília, 06 de janeiro de 2020.

Luciano C. Freitas
Físico CNEN/RT 0401
ABFM RT 439/1877



G7 Proteção Radiológica

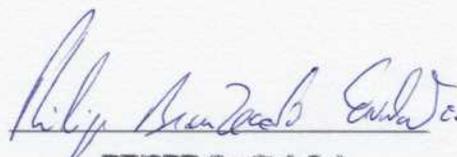

RT/SPR (Instituição)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Permanente de Credenciamento

ATA

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PARA FIM DE CREDENCIAMENTO

DO OBJETO: *“Formação da rede credenciada, composta de entidades e de profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica, psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia e de internação psiquiátrica e dependência química para atendimento aos militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas especializadas e laboratórios.”*

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sala da Seção de Credenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Credenciamento, sob a presidência do Maj QOBM/Intd. JOSÉ EDVONALDO DE LIMA, matrícula 1403157, os quais assinam abaixo, a fim de proceder ao julgamento e análise da documentação visando o credenciamento para contratação de empresas especializadas na área de saúde para o CBMDF, que trata o objeto do Edital de Credenciamento 01/2018. Após avaliação de toda documentação e de acordo com o parecer da CPC (61812127), esta comissão CREDENCIA a empresa PERFECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, nome fantasia PERFECTA, inscrita sob o CNPJ nº 38.020.020/0002-88 e situada na SGAS 611, Centro Médico Lucio Costa, bloco 1 sala S-03, Brasília - DF, CEP 70.200-700, no subitem 4.19 (empresas especializadas em radiologia, que realizem procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou não) do item 4 do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de credenciamento nº 00053-00066562/2021-98. Nos termos do subitem 8.4.1 do referido Edital. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão às dezesseis horas do mesmo dia mediante a lavratura da presente Ata.



Documento assinado eletronicamente por **MAX WERNER MAIA BANDEIRA, Ten-Cel. RRm , matr. 1399930, Membro da Comissão Permanente de Credenciamento**, em 13/05/2021, às 09:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELIEZER CANEDO DE SOUZA JUNIOR, 2º Sgt. QBMG-1, matr. 1405533, Membro da Comissão Permanente de Credenciamento**, em 13/05/2021, às 10:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELLEN SIMONE BORGES NASCIMENTO, 2º Sgt. QBMG-1, matr. 1405686, Membro da Comissão Permanente de Credenciamento**, em 13/05/2021, às 10:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA ALVES MORENO, SubTen. QBMG-1, matr. 1405759, Membro da Comissão Permanente de Credenciamento**, em 13/05/2021, às 14:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE EDVONALDO DE LIMA, Maj. QOBM/Intd, matr. 1403157, Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento**, em 13/05/2021, às 14:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=61813233)
verificador= **61813233** código CRC= **F71F04AE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAIS Qd. 04, Lote 05 - Setor Policial - Bairro Asa Sul - CEP 70602-900 - DF
3901-2950



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta

Declaração - CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR

PROCESSO: 00053-00066562/2021-98.

Referência: Inexigibilidade de Licitação nº 56/2021 - PERFECTA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.

Assunto: Declaração de Inexigibilidade.

O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF, no uso das atribuições conferidas pelo art. 33 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 de abril de 2010, c/c o inc. X do art. 212 da Portaria nº 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no suplemento do BG nº 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF e considerando o constante no Parecer nº 1.005/2017 PRCON/PGDF e na Nota Técnica SEI-GDF n.º 211/2018 - CBMDF/GABCG/ASJUR, e tendo em vista o(s) argumento(s) constante(s) na Informação CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR (63562016),

R E S O L V E:

1. **DECLARAR INEXIGÍVEL** licitação, em favor da clínica: PERFECTA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – CNPJ: 38.020.020/0002-88 com despesa inicial de R\$ 1,00 (um real), visando a prestação de serviço na área da saúde, estando habilitada no **subitem 4.19 (empresas especializadas em radiologia, que realizem procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou não), do item 4 do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018** conforme processo de credenciamento e demais documentos acostados aos autos, com base no *caput* do art. 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993;

2. Considerando que a minuta de contrato a ser utilizada no processo será aquela previamente aprovada pela PGDF quando da apreciação do Edital de Credenciamento nº 01/2018, conforme Parecer nº 1.005/2017 PRCON/PGDF (63559939) e Nota Técnica SEI-GDF n.º 211/2018 - CBMDF/GABCG/ASJUR (63559966), esta não será objeto de nova apreciação pela Assessoria Jurídica.

3. **ENCAMINHE-SE** ao Chefe do DEALF, para ratificação da despesa.

Brasília, 09 de junho de 2021.

Diretor de Contratações e Aquisições



Documento assinado eletronicamente por **HELIO PEREIRA LIMA, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400023, Diretor(a) de Contratações e Aquisições do CBMDF**, em 09/06/2021, às 18:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=63563399)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=63563399)
verificador= **63563399** código CRC= **D5CB0495**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013616

00053-00066562/2021-98

Doc. SEI/GDF 63563399



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

PROCESSO: 00053-00066562/2021-98

Referência: Inexigibilidade de Licitação nº 56/2021 - PERFECTA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

Assunto: Ratificação da Inexigibilidade

O Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira do CBMDF, com fulcro no que prescreve o *caput* do Art. 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com o inc. III do Art. 31, do Decreto nº 7.163 de 29 de abril de 2010, c/c o inc. III do art. 46 da Portaria nº 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no suplemento do BG nº 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, **R E S O L V E:**

1) **RATIFICAR A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** realizada pelo Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF, em favor da clínica: PERFECTA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – CNPJ: 38.020.020/0002-88, no valor inicial de R\$ 1,00 (um real), cujo objeto é o credenciamento de empresa para prestação de serviço na área da saúde, a qual foi habilitada no **subitem 4.19 (empresas especializadas em radiologia, que realizem procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou não), do item 4 do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018**, conforme documentos acostados aos autos.

2) **Determinar** ao Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF que:

- Confeccione extrato da matéria para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal;
- Providencie encaminhamento à DISAU para emissão da respectiva Nota de Empenho.
- Após a emissão da Nota de Empenho, o processo deverá retornar para a Diretoria de Contratações e Aquisições para elaboração e assinatura do contrato.

Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira do CBMDF



Documento assinado eletronicamente por **JOSTON ALVES DE SOUSA, Cel. QOBM/Comb, matr. 1399955, Chefe do Departamento de Administração, Logística e Financeira.**, em 10/06/2021, às 18:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
verificador= 63565278 código CRC= B6774572.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF
39013616

00053-00066562/2021-98

Doc. SEI/GDF 63565278

**SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021**

Processo: 00054-00126444/2020-37. O Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados a abertura do certame em epígrafe, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de no máximo 504.000 (quinhentos e quatro mil) bocais descartáveis para etilômetros, da marca ALCOLIZER, modelo LE5, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência, constante do Anexo I do Edital. Valor estimado: R\$ 710.640,00 (setecentos e dez mil, seiscentos e quarenta reais). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia 29/06/2021 às 08h (horário de Brasília/DF). Elemento de despesa: 33.90.39. Cópia do Edital se encontra no sítio: www.gov.br/compras e www.pm.df.gov.br. UASG: 926016. Informações: 3190-5557 e no e-mail: spjpmdf@gmail.com

Brasília/DF, 11 de junho de 2021
BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA
Ordenador de Despesa

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Processo: 00053-00007338/2018-69. Partes: CBMDF X IMPRENSA NACIONAL, CNPJ nº 04.196.645/0001-00. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. UO: 170394. PT: 89302. ND: 339139. FR: 100 (FCDF). Prazo de Vigência: o presente Termo Aditivo entra em vigência a partir de 12/06/2021. Da Ratificação: permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Data da Assinatura: 08/06/2021. Signatários: Pela Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. HÉLIO PEREIRA LIMA, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Marlei Vitorino da Silva, na qualidade de Coordenadora de Relacionamento.

**EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 28/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Processo: 00053-00016610/2021-05. Partes: CBMDF X CLIVAC CLÍNICA DE VACINAS E APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 38.070.413/0001-15. Objeto: prestação de serviços de alergologia, pediatria e clínica médica, conforme item 4 do Projeto Básico, subitens 4.24, 4.38 e 4.51, anexo I do Edital de Credenciamento nº 01/2018. UO: 73901. PT: 28845090300FM0053. ND: 339039. FR: 151 (FCDF). O empenho inicial é de R\$ 1,00 (Um real), conforme Nota de Empenho nº 254/2021, emitida em 06/05/2021, na modalidade ESTIMATIVA. Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação nº 30/2021. Assinatura: 10/06/2021. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. HELIO PEREIRA LIMA, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Marta Pereira de Carvalho, na qualidade de Sócia Administradora.

**EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Processo: 00053-00095468/2020-65. Partes: CBMDF X HOSPITAL DE OLHOS DO DISTRITO FEDERAL S.A – HODF, CNPJ nº 34.639.032/0001-53. Objeto: prestação de serviços de oftalmologia, conforme item 4 do Projeto Básico, subitem 4.36, anexo I do Edital de Credenciamento nº 01/2018. UO: 73901. PT: 89304. ND: 339039. FR: 151 (FCDF). O empenho inicial é de R\$ 1,00 (Um real), conforme Nota de Empenho nº 300/2021, emitida em 27/05/2021, na modalidade ESTIMATIVA. Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação nº 42/2021. Assinatura: 10/06/2021. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. HELIO PEREIRA LIMA, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Augusto Sérgio Evangelista de Holanda, na qualidade de Diretor Presidente.

**EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Processo: 00053-00002577/2020-47. Partes: CBMDF X CLINSP - CLÍNICA DE SAÚDE E PSICOLOGIA LTDA, CNPJ nº 24.195.316/0001-44. Objeto: serviços de psicologia e psiquiatria. UO: 73901. PT: 28845090300FM0053. ND: 339039. FR: 100 (FCDF). O empenho inicial é de R\$ 1,00 (Um real), conforme Nota de Empenho nº 307/2021, emitida em 25/08/2021, na modalidade ESTIMATIVA. Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. Assinatura: 09/05/2021. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. HELIO PEREIRA LIMA, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Érika Chrystian Vitória de Brito, na qualidade de Sócia-Administradora.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo: 00053-00048253/2021-36. Nota de Empenho Ordinário nº 257/2021, emitida em 31/05/2021. Contratada: RCOM DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.875.832/0001-10, no valor de R\$ 96.600,00. Objeto: aquisição de 15 rádios aeronáuticos portáteis e 04 rádios fixos. Fundamento Legal: ARP Nº 02/2021 - CBMDF. Elemento de Despesa: 409052. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. HELIO PEREIRA LIMA, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo: 00053-00015311/2021-45. Nota de Empenho Ordinário nº 258/2021, emitida em 31/05/2021. Contratada: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., CNPJ: 17.800.159/0001-93, no valor de R\$ 134.631,34. Objeto: aquisição de 19 Smart TV 75 polegadas. Fundamento Legal: ARP nº 03/2020 - COLTEC/UFMG. Elemento de Despesa: 449052. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. HELIO PEREIRA LIMA, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo: 00053-00083392/2021-14. Nota de Empenho Ordinário nº 310/2021, emitida em 31/05/2021. Contratada: ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA., CNPJ: 16.812.837/0001-75, no valor de R\$ 454,30. Objeto: borrifador de plástico para PODON/CBMDF. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 22/2021- DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. HELIO PEREIRA LIMA, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo: 00053-00083446/2021-33. Nota de Empenho Ordinário nº 311/2021, emitida em 31/05/2021. Contratada: AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA., CNPJ: 35.171.422/0001-04, no valor de R\$ 2.075,40. Objeto: aquisição de material de consumo para utilização na Policlínica Odontológica do CBMDF. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 22/2021-CBMDF. Elemento de Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. HELIO PEREIRA LIMA, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

**SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E
FINANCEIRA**

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/2021

Processo: 00053-00059413/2021-72. O Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira do CBMDF, com fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c o inciso III do Art. 31, do Decreto nº 7.163 de 29 de abril de 2010, c/c o inc. III do art. 46 da Portaria nº 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no suplemento do BG nº 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, resolve: RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 55/2021 - CBMDF, em favor da Clínica: MB GASTROENTEROLOGIA LTDA – CNPJ: 17.213.119/0001-45, no valor inicial de R\$1,00 (um real) referente ao credenciamento de empresa na área da saúde, habilitada nos subitens 4.26 (empresas especializadas em em coloproctologia), 4.29 (empresas especializadas em endoscopia) e 4.30 (empresas especializadas em gastroenterologia), do item 4 do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018, com dotação orçamentária de R\$ 66.933.191,13 (sessenta e seis milhões, novecentos e trinta e três mil cento e noventa e um reais e treze centavos), UO: 73901 – FCDF, PT: 28.845.0903.00FM.0053, Natureza da Despesa: 33.90.39-50, Fonte 0151. Cel. QOBM/Comb. JOSTON ALVES DE SOUSA - Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira do CBMDF.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 56/2021

Processo: 00053-00066562/2021-98. O Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira do CBMDF, com fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c o inciso III do Art. 31, do Decreto nº 7.163 de 29 de abril de 2010, c/c o inc. III do art. 46 da Portaria nº 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no suplemento do BG nº 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, resolve: RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 56/2021 - CBMDF, em favor da Clínica: PERFECTA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – CNPJ: 38.020.020/0002-88, no valor inicial de R\$1,00 (um real) referente ao credenciamento de empresa na área da saúde, habilitada no subitem 4.19 (empresas especializadas em radiologia, que realizem procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou não), do item 4 do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018, com dotação orçamentária de R\$ 66.933.191,13 (sessenta e seis milhões, novecentos e trinta e três mil cento e noventa e um reais e treze centavos), UO: 73901 – FCDF, PT: 28.845.0903.00FM.0053, Natureza da Despesa: 33.90.39-50, Fonte 0151. Cel. QOBM/Comb. JOSTON ALVES DE SOUSA - Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira do CBMDF.